




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

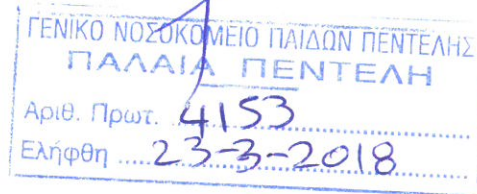

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/03/2018

Αρ. Πρωτ.

Προς: Γραφείο Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΥΓΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Παρακαλούμε ο νέος ζυγός να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως αναλυτικός ζυγός ακριβείας για ζυγίσεις με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων: (0.1 mgr).
2. Να διαθέτει ικανότητα ζύγισης έως -περίπου 160 gr
3. Κατάλληλος για ζύγιση χημικών ουσιών σε στερεά μορφή.
4. Να διαθέτει γυάλινο κλωβό ασφαλείας
5. Να διαθέτει μεταλλική ανθεκτική βάση ζυγίσματος
6. Να διαθέτει μεγάλη LCD φωτεινή οθόνη αναγνώσιμη από απόσταση
7. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης.
8. Να διαθέτει λειτουργία απόβαρου
9. Να διαθέτει σύντομο χρόνο σταθεροποίησης ένδειξης (έως 5 sec)
10. Η προμηθεύτρια εταιρεία να δίνει τεχνική κάλυψη για κάθε τυχόν πρόβλημα και εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.
11. Να υπάρχουν φτηνά και εύκολα ευρισκομενα ανταλλακτικά.
12. Να υπάρχει συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά.

ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Γ.Ν.Π.Π.
ΜΚΑ: 14065703184
Τ.Μ.ΤΣΑΥ: 65729

ΜΥΛΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Β. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ/Β'
Γ.Ν.Π.Π.

ΜΑ ΣΤΑ